


Flowdiagram ved allergi-screening

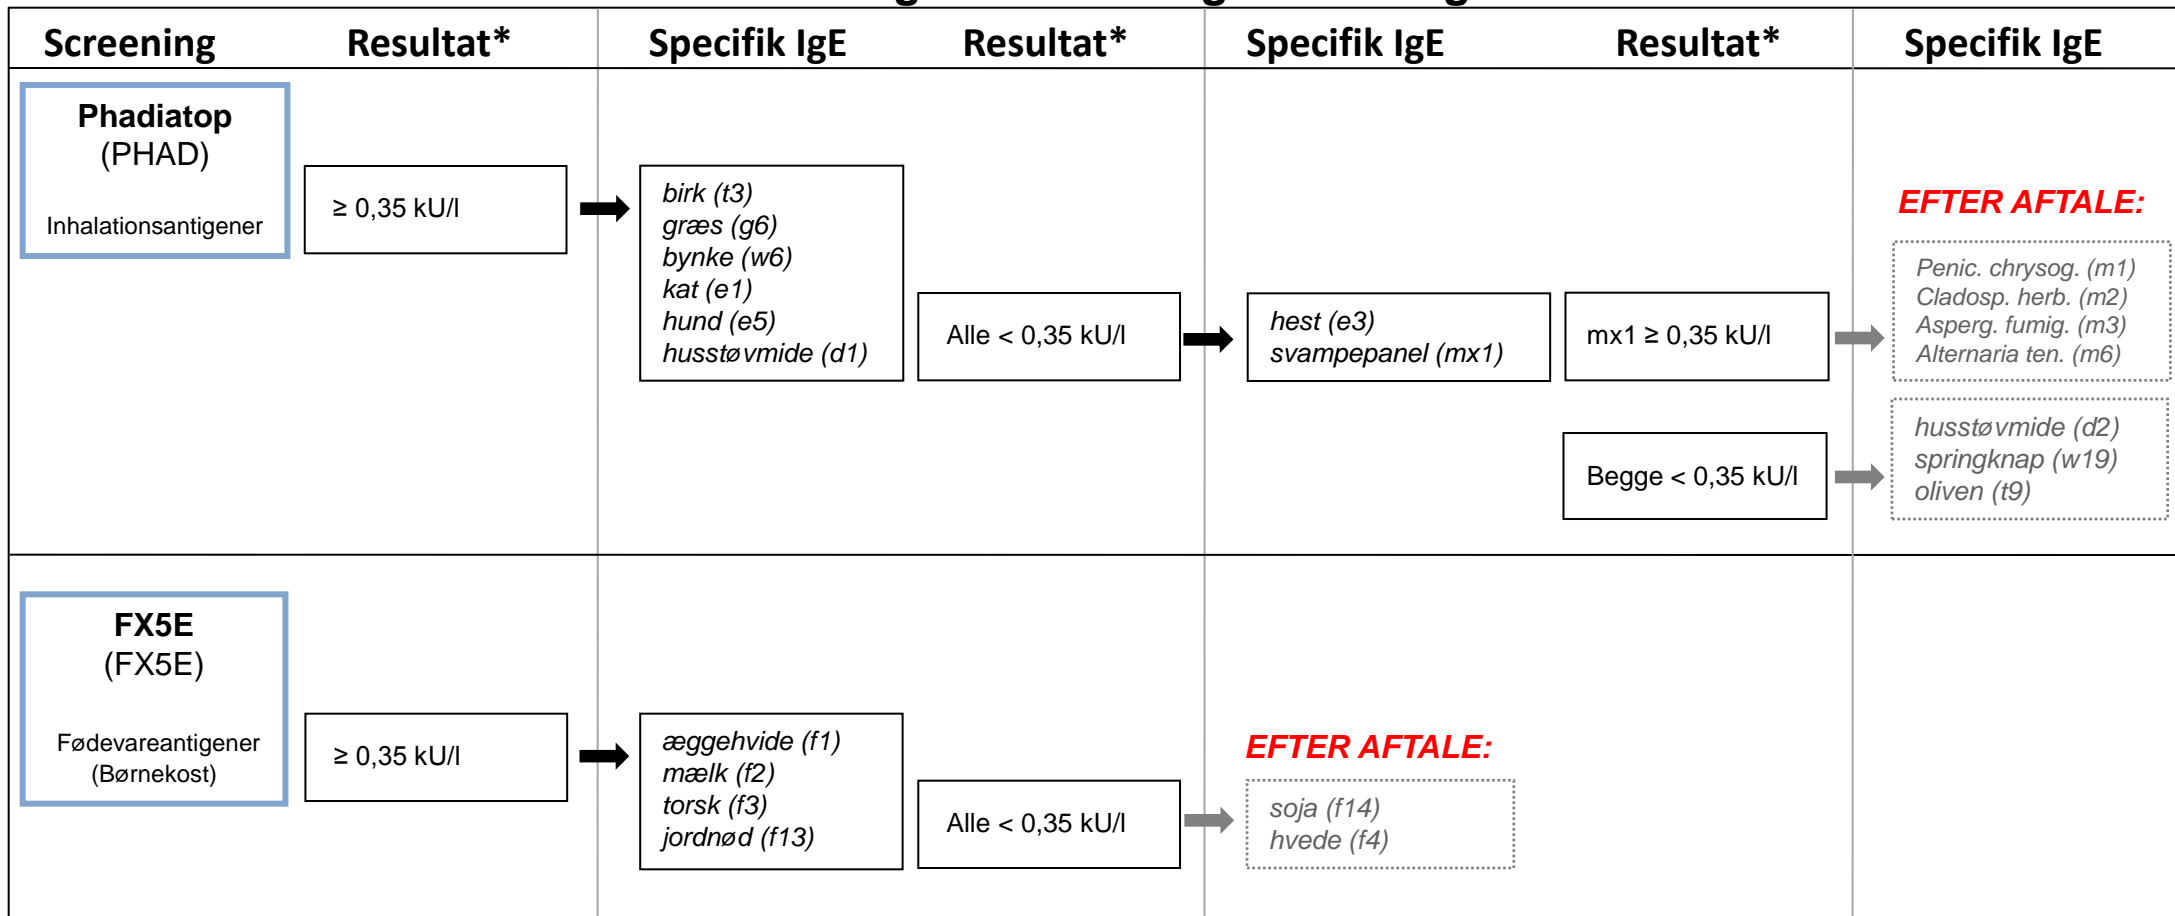

Kontakt vedr. allergianalyser på Klinisk Biokemiske afdelinger Region Midtjylland:

AUH: Mette Degn: mettdegn@rm.dk tlf. 7846 6846

Horsens: Irene Engmark: ireeng@rm.dk tlf. 7842 6005

Midt: Mette Østergaard: mette.oestergaard@midt.rm.dk tlf. 7844 3417

Vest: Inge Lysgaard : inge.lysgaard.nielsen@vest.rm.dk tlf. 7843 5643

***Kvantitativ svarafgivelse:**

Svar ≥ 0,10 kU/l afgives kvantitativt. Svar < 0,10 kU/l afgives som "< 0,10 kU/l".

Forklaring til skema:

Sort pil indikerer at analyse for de specifikke antigener i boksen udløses automatisk. De specifikke antigener skrevet med gråt i stiplede boks indgår i screeningspanelerne men er sjældnere allergene. Disse og evt. yderligere analyser bør primært rekvireres af specialister, og når indikation taler herfor.

Gældende fra d. 1/6-2012. Opdateret 1/10-2015.